

Số: 4487/BM-HCQT  
V/v Máy thổi khí cho hệ thống xử lý  
nước thải

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua máy thổi khí cho Hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Bạch Mai” với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Quang Tuấn, Chuyên viên phòng Hành chính quản trị, SĐT: 0986898385
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại Bộ phận Văn thư - Văn phòng Bệnh viện.
  - Nhận qua email: [vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn](mailto:vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn)
  - Nhận qua fax: 024 38691607
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 07/11/2023 đến trước 16h00 ngày 21/11/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III/2023.
- Các yêu cầu khác:



✓


Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang) và theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

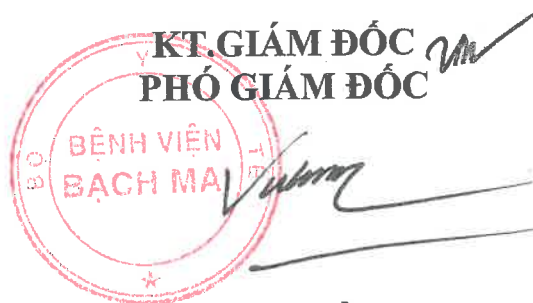


The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text "BỘ Y" is on the left and "BỆNH VIỆN BẠCH MÃ" is on the right. A small star is at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Vũ Văn Hồng**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text "BỘ Y" is at the top and "BỆNH VIỆN BẠCH MÃ" is in the center. A small star is at the bottom.



A small handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

## DANH MỤC CẦN BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 4487 /BM-HCQT ngày 07/11/2023)

STT	Tên Hàng Hoá	Số lượng	Đơn vị tính
1	<b>Máy thổi khí</b> <b>I. Yêu cầu chung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Máy mới: 100%</li><li>Sản xuất năm 2023 trở lên</li><li>Bảo đảm chất lượng ISO 14001:2015</li><li>Nguồn điện: 50hz-60hz/ 380-400 V</li></ul> <b>II. Cấu hình chung:</b> <p>a) Máy chính: 01 cái</p> <p>b) Phụ kiện đi kèm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Van đẩy, van 1 chiều, 02 van</li><li>Ống giảm thanh hút (bao gồm cả bộ lọc khí): 01 cái</li><li>Puli (cho máy thổi khí và motor): 01 cái,</li><li>Khớp nối mềm: 01 cái</li><li>Dây cua-roa: 01 bộ</li><li>Đồng hồ áp lực: 01 cái</li><li>Khung đế: 01 bộ</li><li>Đai V và bộ bảo vệ đai: 01 bộ</li></ul> <b>III. Cấu hình kỹ thuật:</b> <p>a) Lưu lượng từ : <math>\geq 32</math> m<sup>3</sup>/min</p> <p>b) Cột áp: <math>\geq 4</math>mH<sub>2</sub>O</p> <p>c) Công suất động cơ yêu cầu : <math>\leq 37</math>kw (càng nhỏ - điện năng tiêu thụ càng thấp)</p> <p>d) Tốc độ vòng quay: <math>\leq 1710</math> rpm (tốc độ càng nhỏ - độ ồn càng thấp) , dòng dọc loại 2</p> <p>e) Đường kính đầu thổi: 200mm (yêu cầu bắt buộc để đáp ứng với đường ống của hệ thống)</p> <p>f) Vật liệu thiết bị:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rotor: FCD 450</li><li>- Vỏ máy, hộp số: gang đúc FC200</li><li>- Bánh răng: Chromium molybdenum steel (SCM 415);</li><li>- Oil seal: Fluorubber và N.B.R;</li><li>- Check Valve: EPDM;</li></ul> <p>g) Bộ giảm thanh làm mát cải tiến: Cooling Silencer</p> <p>h) Kích thước: Dài 1358 x rộng 510 x cao 1203 (tham chiếu)</p>	01	Cái

(Đơn vị tham gia báo giá, có bản khảo sát lắp đặt để đảm bảo đồng bộ với hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện)



✓